

**PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI
"DISPOSITIVI MEDICI PER RIANIMAZIONE"**

**VERBALE DI VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA E
CAMPIONATURA**

In data 6 novembre 2013, alle ore 10.00, in Savona nei locali della S.C. Farmacia dell'Ospedale Savona, sito in Via Genova, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione Tecnica nominata con Deliberazione n. 652 del 11/07/2013, incaricata di procedere alla valutazione dei prodotti proposti dalle Ditte partecipanti alla procedura ristretta per la fornitura in oggetto.

La Commissione Tecnica è presente all'unanimità ed è composta dai Signori:

Presidente: Dottor Brunello BRUNETTO

Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione

Componente: Dottor Giorgio BARABINO

Direttore S.C. Anestesia e Rianimazione P.O. Ponente

Componente: Dottor Gianni FOLCO

Responsabile S.S. Terapia Semi Intensiva

Componente: Dottoressa Silvia SARACCO

Responsabile S.S. Terapia Nutrizionale ed Enterale

Componente: Dottoressa Gianna NEGRO

Responsabile S.S. Dispositivi Medici e Galenica Clinica

La Commissione, prende atto che le offerte tecniche (schede tecniche e campionatura) sono adeguatamente custodite in armadio chiuso a chiave (numero inventario 26805), presso la S.C. Farmacia dell'Ospedale San Paolo di Savona.



Di seguito, la Commissione procede con l'esame della documentazione tecnica e della campionatura presentata per i lotti 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Le risultanze delle valutazioni effettuate, assunte all'unanimità dei componenti, sono riportate nelle schede allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

Alle ore 14.00 la Commissione conclude i propri lavori, prima di concludere la seduta il Presidente della Commissione giudicatrice provvede a riporre, dinanzi la Commissione, le buste della documentazione tecnica e i plichi contenenti la campionatura in un armadio dotato di serratura (n. inventario 26805) della Struttura Farmacia Ospedaliera dell'Ospedale San Paolo di Savona, e a chiudere il suddetto a chiave.

Il presente verbale si compone di n. 2 facciate.

Letto, approvato e sottoscritto.


Il Presidente Commissione Giudicatrice
Dottor Brunello BRUNETTO




Componente
Dottorressa Gianna NEGRO



Componente
Dottor Gianni FOLCO



Componente
Dottor Giorgio BARABINO

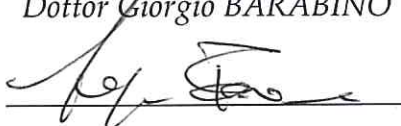

Componente
Dottorressa Silvia SARACCO






| LOTTO 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|----------|---------|--------|---------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|----------|---------|---|------------------------|
| maschera pediatrica per ossigenoterapia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUB CRITERI e criteri motivazionali | P. max | AIR LIQUIDE | | BENEFITS | | COVIDIEN | | DEAS | | MEDISIZE | | SMITHS MEDICAL | | TELEFLEX | | | |
| | | coeff. | P. zz,j | coeff. | P. zz,j | coeff. | P. zz,j | coeff. | P. zz,j | coeff. | P. zz,j | coeff. | P. zz,j | coeff. | P. zz,j | | |
| Adattabilità della maschera alla conformazione anatomica del paziente e termoplasticità | 30 | 0,75 | Materiale rigido e poco conformabile | 0,75 | Materiale rigido e poco conformabile | 1 | 30 | 1 | 30 | 0,75 | Materiale rigido e poco conformabile | NON VALUTABILE PER ASSENZA RESERVOIR | | | | 1 | 30 |
| Qualità del materiale come atraumaticità della lavorazione | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | | | | | 1 | 20 |
| Resistenza del tubo al collabimento | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | | | | | 0 | Non antingnocchiamento |
| PUNTEGGI COMPLESSIVI | | | 52,5 | | 52,5 | | 60 | | 60 | | 52,5 | | | | | | 50 |

60

52,5

50

| LOTTO 2 | | | | | | | | | |
|---|--------|--|----|--|----|--|----|----------|-----------|
| RACCORDO PER OSSIGENOTERAPIA (COD. 40267) | | | | | | | | | |
| SUB CRITERI e criteri motivazionali | P. max | AIR LIQUIDE | | BENEFIS | | DEAS | | MEDISIZE | |
| | | coeff. | P. | coeff. | P. | coeff. | P. | coeff. | P. |
| Qualità del materiale | 20 | NON VALUTATO - ASSENZA DEL SISTEMA VENTURI | | NON VALUTATO - ASSENZA DEL SISTEMA VENTURI | | NON VALUTATO - ASSENZA DEL SISTEMA VENTURI | | 1 | 20 |
| Qualità delle connessioni con la maschera | 20 | | | | | | | 1 | 20 |
| Resistenza del tubo al collabimento | 20 | | | | | | | 1 | 20 |
| PUNTEGGI COMPLESSIVI | | | | | | | | | 60 |

| LOTTO 2 | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--|----|--|----|--|----|----------|-----------|--|--|
| FORCELLE NASALI (COD. 40268/208108/208109) | | | | | | | | | | | |
| SUB CRITERI e criteri motivazionali | P. max | AIR LIQUIDE | | BENEFIS | | DEAS | | MEDISIZE | | | |
| | | coeff. | P. | coeff. | P. | coeff. | P. | coeff. | P. | | |
| Adattabilità alla conformazione anatomica del paziente e termoplasticità del materiale | 30 | NON VALUTATO - ASSENZA DEL SISTEMA VENTURI | | NON VALUTATO - ASSENZA DEL SISTEMA VENTURI | | NON VALUTATO - ASSENZA DEL SISTEMA VENTURI | | 1 | 30 | | |
| Atraumaticità della lavorazione | 20 | | | | | | | 1 | 20 | | |
| Resistenza del tubo al collabimento | 10 | | | | | | | 1 | 10 | | |
| PUNTEGGI COMPLESSIVI | | | | | | | | | 60 | | |

GFR

12

12

12




12

| LOTTO 2 | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|----|--|----|--|----|----------|-----------|--|--|
| MASCHERA C/NEBULIZZATORE DI PARTICELLE (COD. 40269/208112) | | | | | | | | | | | |
| SUB CRITERI e criteri motivazionali | P. max | AIR LIQUIDE | | BENEFIS | | DEAS | | MEDISIZE | | | |
| | | coeff. | P. | coeff. | P. | coeff. | P. | coeff. | P. | | |
| Adattabilità della maschera alla conformazione del paziente e termoplasticità del materiale | 30 | NON VALUTATA - ASSENZA DEL SISTEMA VENTURI | | NON VALUTATA - ASSENZA DEL SISTEMA VENTURI | | NON VALUTATA - ASSENZA DEL SISTEMA VENTURI | | 1 | 30 | | |
| Ampiezza range delle particelle nebulizzate | 10 | | | | | | | 1 | 10 | | |
| Atraumaticità della lavorazione | 10 | | | | | | | 1 | 10 | | |
| Resistenza del tubo al collabimento | 10 | | | | | | | 1 | 10 | | |
| PUNTEGGI COMPLESSIVI | | | | | | | | | 60 | | |




W

87



| LOTTO 2 | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|----|---------|----|--------|----|----------|----|--------|----|-----------|
| MASCHERA PER OSSIGENOTERAPIA ADULTI E BAMBINI (COD. 40266/208117) | | | | | | | | | | | | |
| SUB CRITERI e criteri motivazionali | P. max | AIR LIQUIDE | | BENEFIS | | DEAS | | MEDISIZE | | | | |
| | | coeff. | P. | coeff. | P. | coeff. | P. | coeff. | P. | coeff. | P. | P. |
| Adattabilità della maschera alla conformazione anatomica del paziente e termoplasticità del materiale | 30 | NON VALUTATE - ASSENZA DEL SISTEMA VENTURI | | | | | | | | | | |
| Resistenza del tubo al collabimento | 10 | | | | | | | | | | | |
| Disponibilità di diversi dispositivi valvolari | 20 | | | | | | | | | | | |
| PUNTEGGI COMPLESSIVI | | | | | | | | | | | | 60 |

| LOTTO 2 | | | | | | | | | |
|---|--------|--|----|--|----|--|----|----------|-----------|
| SONDINO PER OSSIGENOTERAPIA (COD 40265) | | | | | | | | | |
| SUB CRITERI e criteri motivazionali | P. max | AIR LIQUIDE | | BENEFIS | | DEAS | | MEDISIZE | |
| | | coeff. | P. | coeff. | P. | coeff. | P. | coeff. | P. |
| Qualità del materiale | 30 | NON VALUTATO - ASSENZA DEL SISTEMA VENTURI | | NON VALUTATO - ASSENZA DEL SISTEMA VENTURI | | NON VALUTATO - ASSENZA DEL SISTEMA VENTURI | | 1 | 30 |
| Qualità delle connessioni | 20 | | | | | | | 1 | 20 |
| Resistenza del tubo al collabimento | 10 | | | | | | | 1 | 10 |
| PUNTEGGI COMPLESSIVI | | | | | | | | | 60 |

| LOTTO 3 | | | | | | | | | |
|---|--------|----------|--|----------|--|---------|-----------|----------------|--|
| SIST. CHIUSO ASPIRAZIONE SECREZIONI VIE AEREE | | | | | | | | | |
| SUB CRITERI e criteri motivazionali | P. max | COVIDIEN | | MEDISIZE | | MEDIVAL | | SMITHS MEDICAL | |
| | | coeff. | P. | coeff. | P. | coeff. | P. | coeff. | P. |
| Qualità del materiale | 20 | 0,75 | 15 materiale piuttosto rigido | 0,75 | 15 finitura parte distale non ottimale | 1 | 20 | 1 | 20 |
| | | | | | | | | | |
| Maneggevolezza del prodotto | 20 | 0,75 | 15 ergonomia non ottimale | 0,75 | 15 ergonomia non ottimale | 1 | 20 | 0,75 | 15 ergonomia non ottimale |
| | | | | | | | | | |
| Prestazioni accessori eventuali | 20 | 0,5 | 10 assenza di accessori | 0,5 | 10 accessori non adeguati alle esigenze | 1 | 20 | 0,5 | 10 accessori non adeguati alle esigenze |
| | | | | | | | | | |
| PUNTEGGI COMPLESSIVI | | | 40 | | 40 | | 60 | | 45 |

| LOTTO 15 | | | | | | | | | |
|--|--------|----------|-----------|------------------|----|------------------|----|--|--|
| RACCORDI E RACCOGLICONDENZA MONOUSO PER VENTILAZIONE | | | | | | | | | |
| SUB CRITERI e criteri motivazionali | P. max | COVIDIEN | | DEAS | | MEDIVAL | | | |
| | | coeff. | P. | coeff. | P. | coeff. | P. | | |
| Qualità del materiale e finitura dei raccordi | 30 | 1 | 30 | LOTTO INCOMPLETO | | LOTTO INCOMPLETO | | | |
| Maneggevolezza nel posizionamento | 10 | 1 | 10 | | | | | | |
| Fraticità d'uso | 20 | 1 | 20 | | | | | | |
| PUNTEGGI COMPLESSIVI | | | 60 | | | | | | |

CTE
b
B
Z
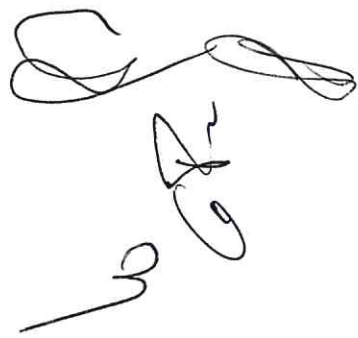
| LOTTO 16 | | | | | | | | | |
|---|--------|---------------|------|---------|-----------|--------|-----------|----|----|
| SISTEMI PER ACCESSO VENOSO MIDLINE | | | | | | | | | |
| SUB CRITERI e criteri motivazionali | P. max | BARD | | GADOMED | | SEDA | | P. | P. |
| | | coeff. | P. | coeff. | P. | coeff. | P. | | |
| Qualità del materiale e finitura dei raccordi | 30 | Ha presentato | PICC | 1 | 30 | 1 | 30 | | |
| Maneggevolezza nel posizionamento | 15 | | | 1 | 15 | 1 | 15 | | |
| Qualità del sistema di fissaggio alla cute | 15 | | | 1 | 15 | 1 | 15 | | |
| PUNTEGGI COMPLESSIVI | | | | | 60 | | 60 | | |

CR
b
D
Z



| LOTTO 17 | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------|--|----------|-----------|---------------|--|---|--|
| CONTENITORE ASPIRAMUCO STERILE | | | | | | | | | |
| SUB CRITERI e criteri motivazionali | P. max | BENEFIS | | COVIDIEN | | JANUA MEDICAL | | P. | |
| | | coeff. | P. | coeff. | P. | coeff. | | | |
| Qualità dei raccordi | 15 | 0,75 | 11,25 difficoltà di connessione all'aspirazione | 1 | 15 | 1 | | 15 | |
| Qualità del materiale | 15 | 0,75 | 11,25 materiale dei tubi di connessione rigido | 1 | 15 | 0,5 | | 7,5 materiale dei tubi di connessione molto rigido | |
| Qualità del dispositivo di prelievo | 15 | 0,75 | 11,25 piuttosto rigido | 1 | 15 | 0,75 | | 11,25 piuttosto rigido | |
| Praticità di utilizzo | 15 | 0,5 | 7,5 ergonomia non ottimale | 1 | 15 | 0,25 | | 3,75 difficile la chiusura rischio di contaminazione | |
| PUNTEGGI COMPLESSIVI | | | 41,25 | | 60 | | | 37,5 | |




LOTTO 18

CATETERE VESCICALE CON SONDA INTEGRATA PER RILEVAMENTO/MONITORAGGIO TEMPERATURA CORPOREA

| SUB CRITERI e criteri motivazionali | P. max | COVIDIEN | | SMITHS MEDICAL | |
|---|--------|----------|-----------|----------------|-----------|
| | | coeff. | P. | coeff. | P. |
| Qualità del materiale e finitura dei raccordi | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| Maneggevolezza nel posizionamento | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| Praticità d'uso | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| PUNTEGGI COMPLESSIVI | | | 60 | | 60 |

| LOTTO 19 | | | | | | | | | |
|---|--------|----------|---|--------|---|-----------------------------------|----|----------|-----------|
| KIT ARTERIA RADIALE | | | | | | | | | |
| SUB CRITERI e criteri motivazionali | P. max | B. BRAUN | | BARD | | COOK ITALIA | | TELEFLEX | |
| | | coeff. | P. | coeff. | P. | coeff. | P. | coeff. | P. |
| Qualità del materiale e finitura dei raccordi | 30 | 0,5 | 15 materiale rigido | 0,75 | 15 materiale rigido | CAMPIONI CON ETICHETTATURA ERRATA | | 1 | 30 |
| Maneggevolezza nel posizionamento | 10 | 0,5 | alette fissaggio poco compatibili con sistemi needle less | 0,5 | alette fissaggio poco compatibili con sistemi needle less | | | 1 | 10 |
| Praticità d'uso | 20 | 0,5 | 10 guida di difficile estrazione dalla protezione | 0,5 | 10 guida di difficile estrazione dalla protezione | | | 1 | 20 |
| PUNTEGGI COMPLESSIVI | | | 30 | | 30 | | | | 60 |

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'S' and 'B' and a signature that appears to be 'CR'.

LOTTO 20

KIT ARTERIA FEMORALE

| SUB CRITERI e criteri motivazionali | P. max | B. BRAUN | | BARD | | COOK ITALIA | | TELEFLEX | |
|---|--------|----------|---|--------|---|-------------|-------------------|----------|-----------|
| | | coeff. | P. | coeff. | P. | coeff. | P. | coeff. | P. |
| Qualità del materiale e finitura dei raccordi | 30 | 0,75 | 15 materiale rigido | 0,75 | 15 materiale rigido | Campioni | con etichettatura | 1 | 30 |
| Maneggevolezza nel posizionamento | 10 | 0,5 | alette fissaggio poco compatibili con sistemi needle less | 0,5 | alette fissaggio poco compatibili con sistemi needle less | errata | | 1 | 10 |
| Praticità d'uso | 20 | 0,5 | 10 guida di difficile estrazione dalla protezione | 0,5 | 10 guida di difficile estrazione dalla protezione | | | 1 | 20 |
| PUNTEGGI COMPLESSIVI | | | 30 | | 30 | | | | 60 |

| LOTTO 21 | | | | | | | | | |
|--|--------|------------|-----------------------|------------------------------|------------|---------------|-----------|--|--|
| SET MONOUSO PER BIOPSIA EPATICA | | | | | | | | | |
| SUB CRITERI e criteri motivazionali | P. max | BIOPSYBELL | | GADOMED | | JANUA MEDICAL | | | |
| | | coeff. | P. | coeff. | P. | coeff. | P. | | |
| Qualità del materiale | 20 | 1 | 20 | non conforme al disciplinare | presentato | 1 | 20 | | |
| Praticità di utilizzo/allestimento del set | 20 | 1 | 20 | G 18 | anziché | 1 | 20 | | |
| Composizione del set | 20 | 0,25 | 5 solo siringa ed ago | G 16 | | 1 | 20 | | |
| PUNTEGGI COMPLESSIVI | | | 45 | | | | 60 | | |

CR
L
Z